


トレーサビリティ体系図

測定項目： PIVKA-II (ヒコルミPIVKA-II MONO)

2017年4月
積水メディカル株式会社

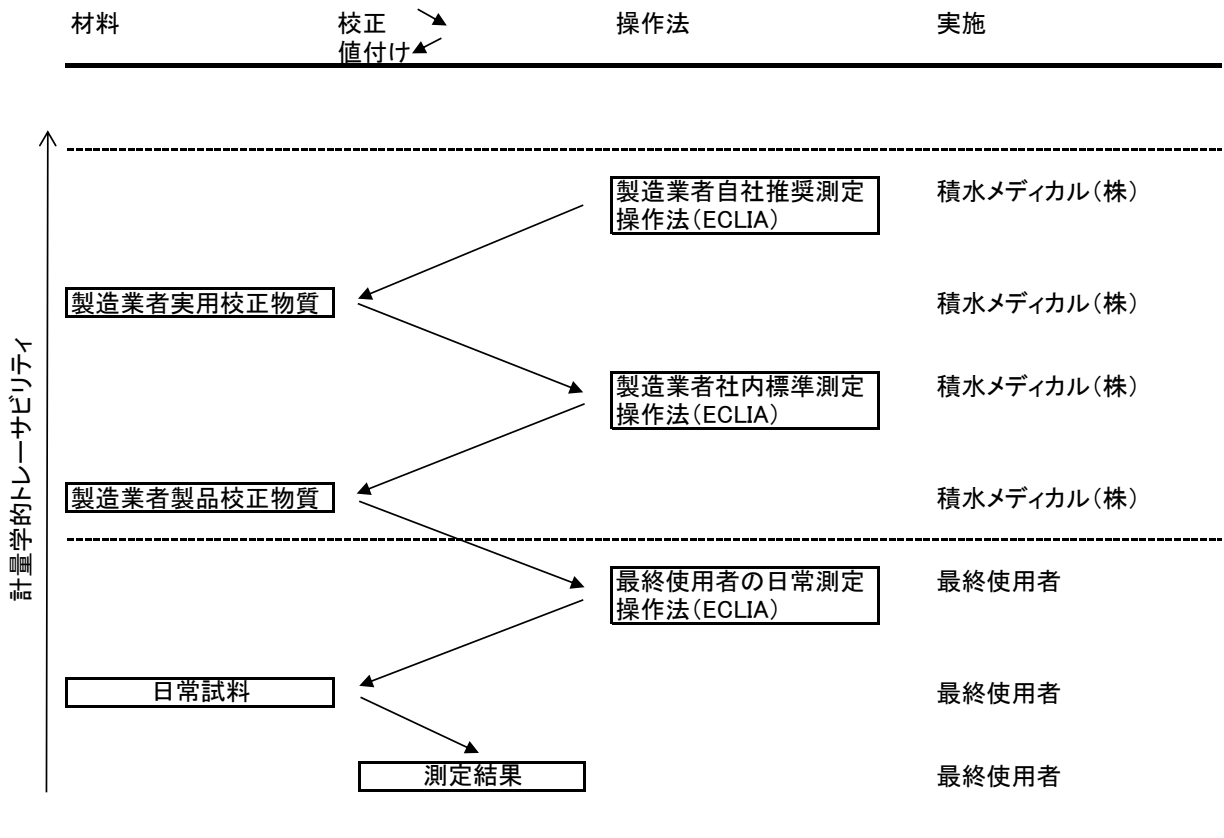

キャリブレーター : キット内添付 不確かさ
表示値 : 1,000 mAU/mL