


トレーサビリティ体系図

測定項目： シアル化糖鎖抗原KL-6(ピコルミKL-6)

2017年4月
積水メディカル株式会社

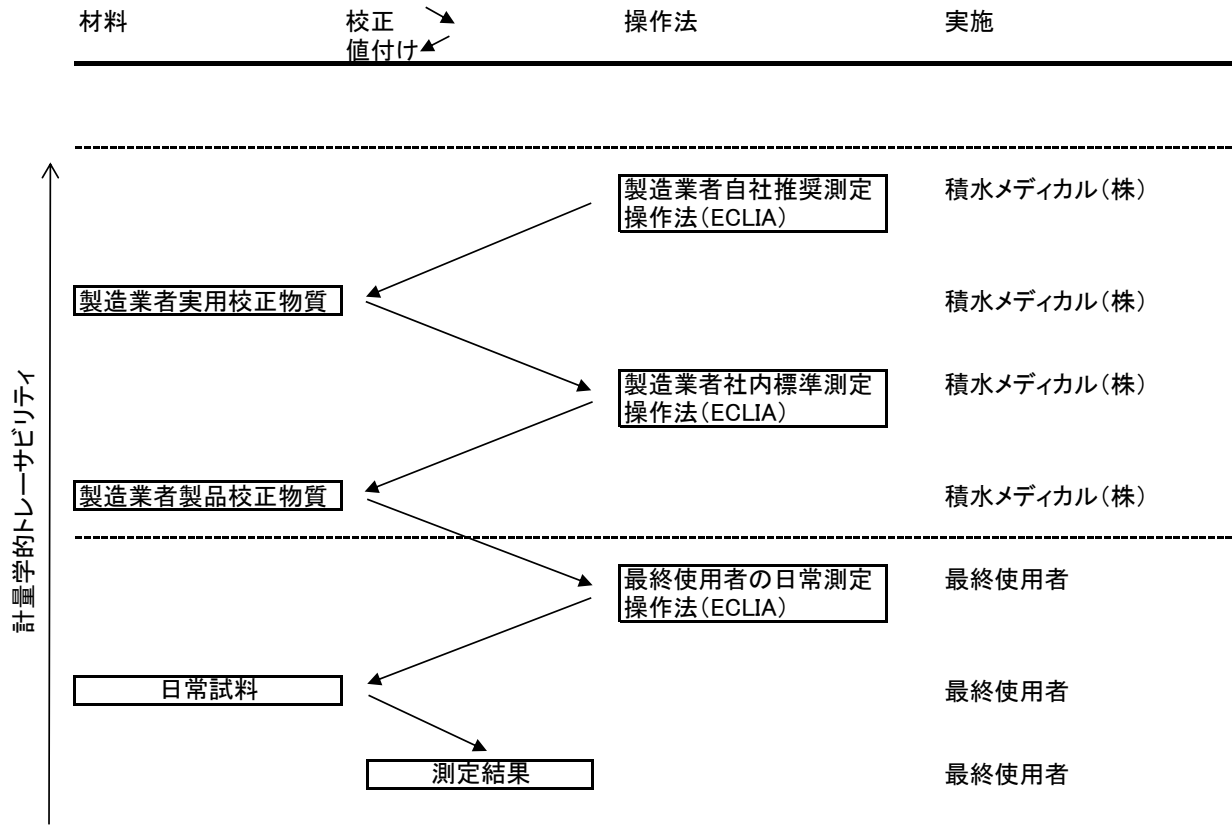

キャリブレーター
表示値 : キット内添付
: 100 U/mL

不確かさ
100 ± 4.0 U/mL