


エベロリムス(ナノピア)

2014年1月作成

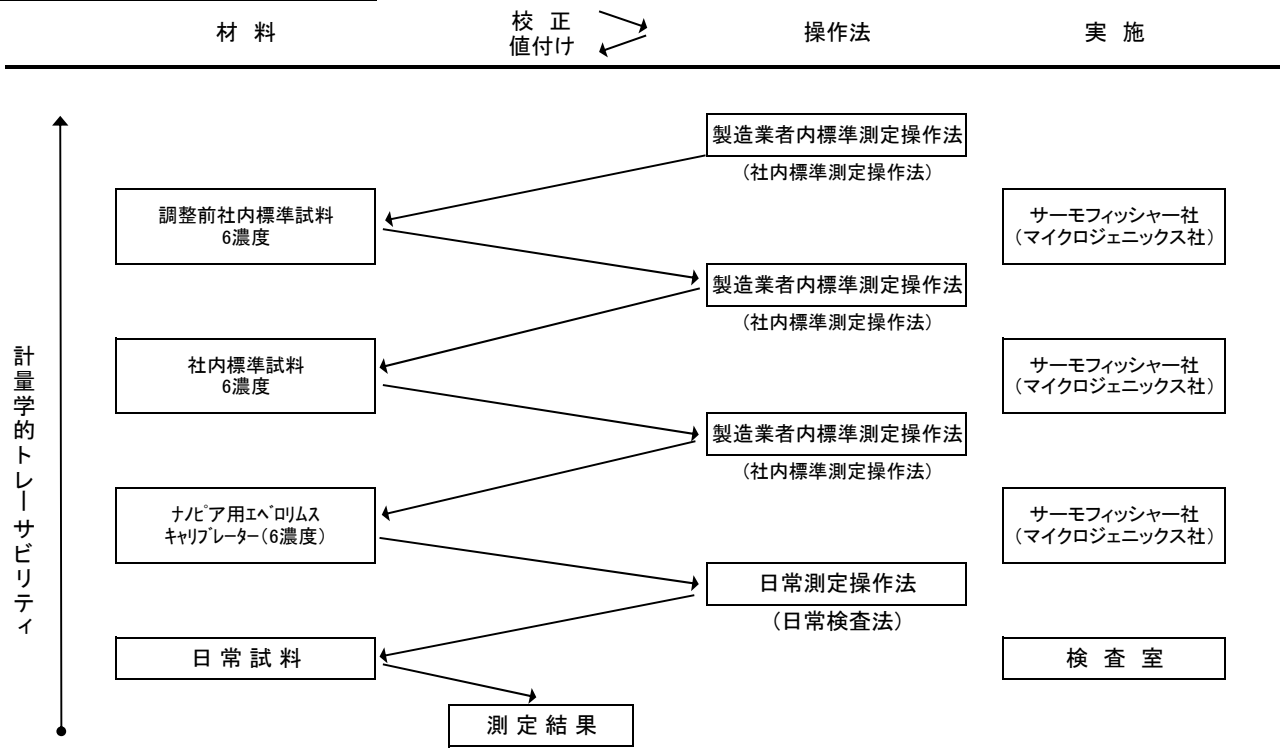

測定 の トレーサビリティ と 不確かさ

メーカー名	サーモフィッシャー社(マイクロジェニックス社)
項目名	エベロリムス(ナノピア)
試薬名	ナノピアTDM エベロリムス
機器名	日立自動分析装置7170
承認番号	22400AMX01415000
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	ナノピア用 エベロリムスキャリブレーター(6濃度)
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質				
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者社内 標準物質	調整前社内標準試料 6濃度			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者社内 標準物質	社内標準試料 6濃度			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	ナノピア用エベロリムス キャリブレーター(6濃度)		-25~-15°C 1年間	
精度管理物質 (製品コントロール)				