


タクロリムス(ナノピア)

2015年10月作成

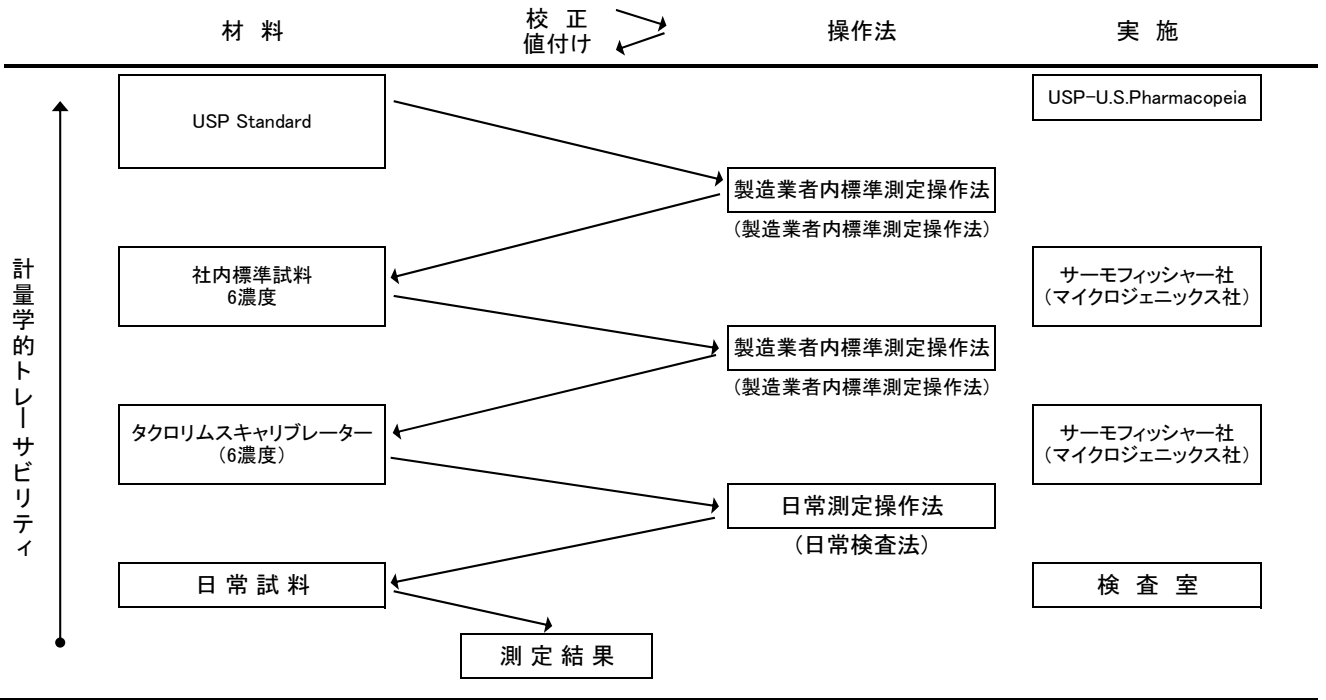

測定 の トレーサビリティ と 不確かさ

メーカー名	積水メディカル
項目名	タクロリムス(ナノピア)
試薬名	ナノピアTDM タクロリムス
機器名	日立自動分析装置7170
認証番号	226ADAMX00197000
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	タクロリムスキャリブレーター(6濃度)
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質	USP Standard			
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者社内 標準物質	社内標準試料 6濃度			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	タクロリムスキャリブレーター (6濃度)		-20±5°C 1年間	
精度管理物質 (製品コントロール)				