


## トレーサビリティチェーン 体系図

測定項目: AIA-CL用 PIVKA-II 較正試薬セット (別売の製品名)  
CL AIA-PACK PIVKA-II ADJUSTER SET

作成日: 2017/3/13

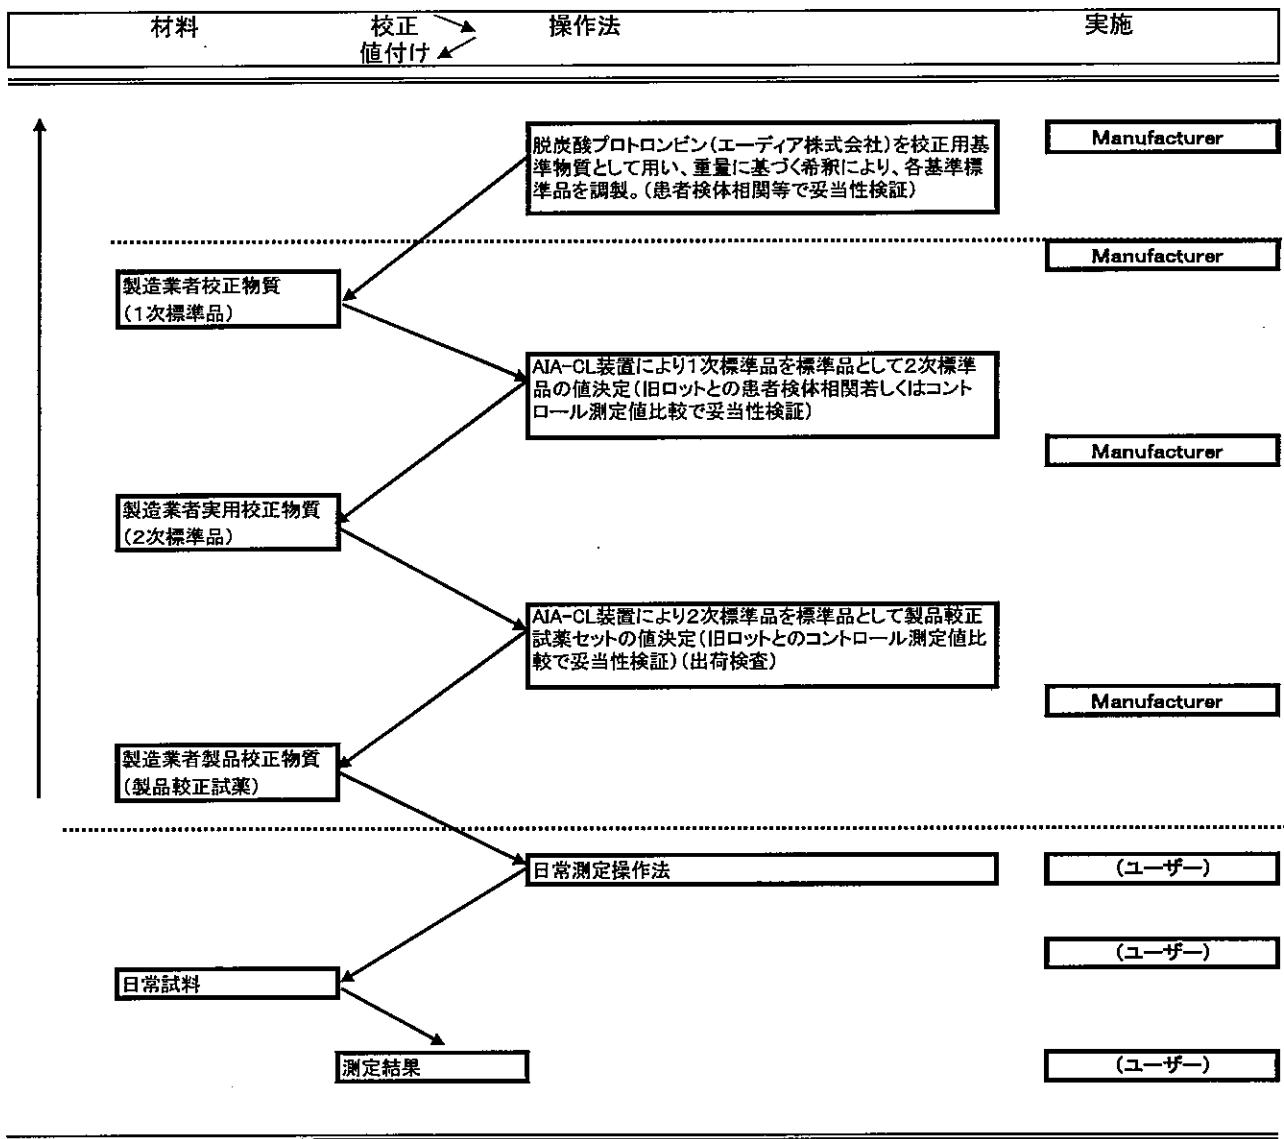

キャリブレータメーカー: 東ソー株式会社(製造販売元)  
 キャリブレータ名称: AIA-CL用 PIVKA-II 較正試薬セット  
CL AIA-PACK PIVKA-II ADJUSTER SET

表示値		不確かさ(*)	
値	単位	値	単位
1	mAU/mL		mAU/mL
2	mAU/mL		mAU/mL
3	mAU/mL		mAU/mL
4	mAU/mL		mAU/mL
5	mAU/mL		mAU/mL
6	mAU/mL		mAU/mL
7			
8			
9			
10			

\*: 包含係数k=2(95%信頼区間)