

アポリポ蛋白 C-II


2008年7月作成

材 料

校 正
値 付 け

操 作 法

実 施

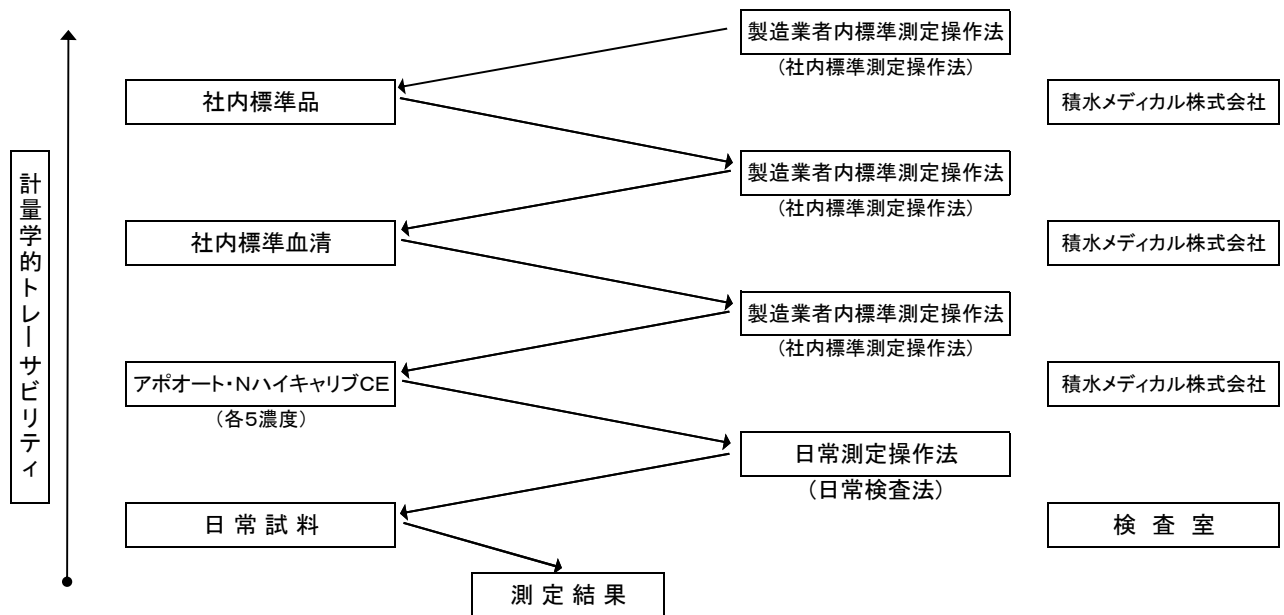

測 定 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ

メーカー名	積水メディカル株式会社
項目名	アポリポ蛋白 C-II
試薬名	アポC-II オート・N「第一」
機器名	日立自動分析装置 7170
届出番号	20800AMZ00124000
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	アポオート・NハイキャリブCE(5濃度)
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質				
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法 (社内標準測定操作法)		
製造業者社内 標準物質	社内標準品			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法 (社内標準測定操作法)		
製造業者社内 標準物質	社内標準血清			
製造業者常用 測定操作法		製造業者内標準測定操作法 (社内標準測定操作法)		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	アポオート・NハイキャリブCE(5濃度)		2~10℃ 製造後12ヵ月	
精度管理物質 (製品コントロール)				