


# フェノバルビタール (ナノピア)

2014年1月作成

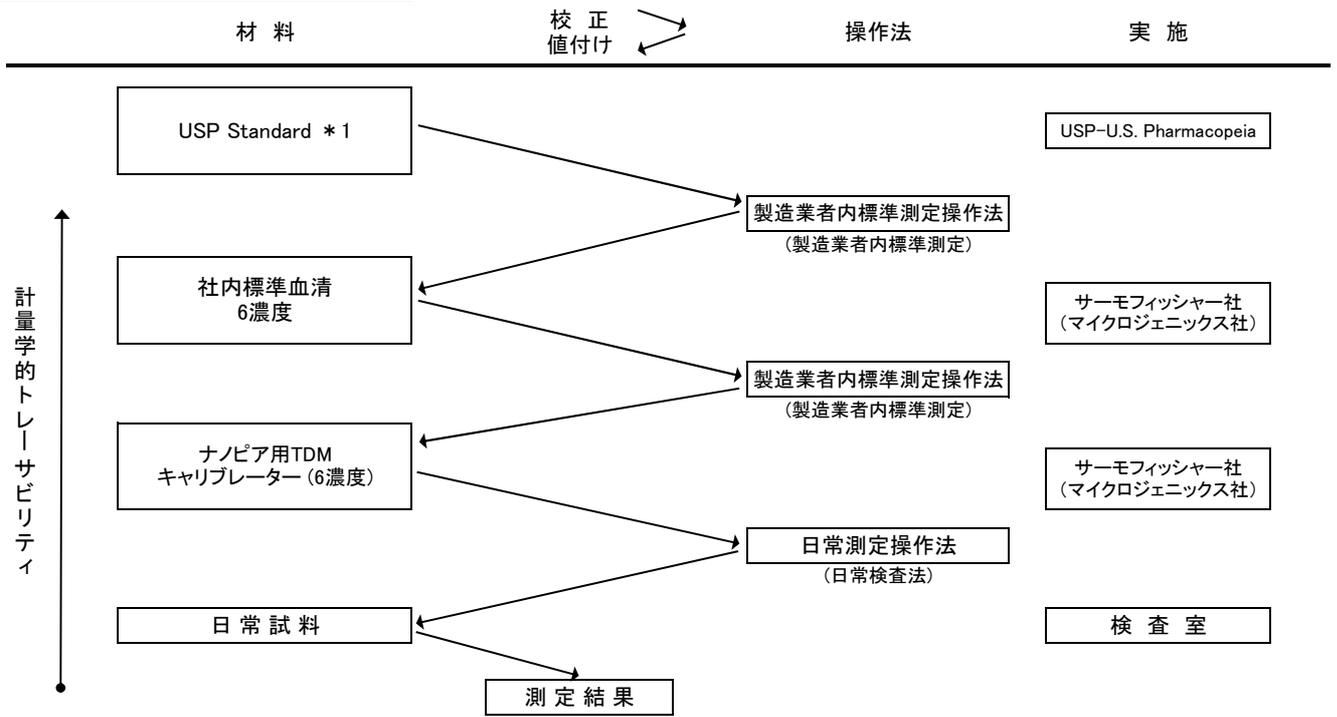

## 測定 の ト レ ー サ ビ リ ティ と 不 確 か さ

メーカー名	サーモフィッシャー社(マイクロジェニックス社)
項目名	フェノバルビタール (ナノピア)
試薬名	ナノピアTDM フェノバルビタール
機器名	日立自動分析装置 7170
届出番号	13A2X00197218104
製造業者製品 校正物質 (製品キャリアプレート)	ナノピア用TDM キャリブレーター (6濃度)
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質	USP Standard *1			
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者社内 標準物質	社内標準血清 6濃度			
製造業者社内 標準測定操作法		製造業者内標準測定操作法		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリアプレート)	ナノピア用TDM キャリアプレート (6濃度)		2~8°C 24か月	
精度管理物質 (製品コントロール)				

\* 1: USP Standard (米国薬局方 標準品、厚生労働省告示第120号で指定されている標準品)